




T2コントローラーを使用するにあたり、店舗にて「T2リモート」機能の設定を必ず行ってください。

各部名称

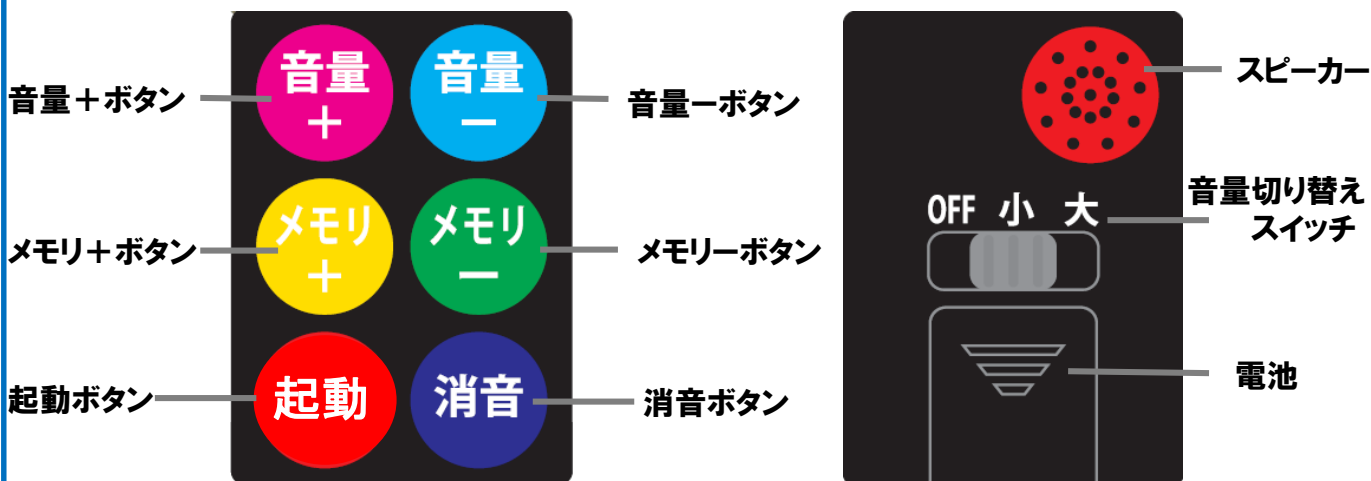

ご使用の際は、必ず **起動** を押してから他のボタンを押してください。


起動ボタンを押すことにより、補聴器側のリモコン機能のスイッチがONになります。



他のボタンを押す

**こんなときは
下の図のようにしてください。**


● 音を大きくしたい



● 音を小さくしたい




● メモリー/プログラムを変更したい



※連続で操作を行いたい場合は、
20秒以内であれば起動ボタン
を再び押さずに操作可能です。


● 音を一時的に止めたい



● 片耳だけ操作したい



● 両耳を操作したい



<使用上の注意>

- ・ 起動ボタンを押して、ピロピロと音がしてから約20秒操作を行わない場合、再度起動ボタンを押し動作を行ってください。
- ・ 補聴器の電源を切ると、元の設定に戻ります。
- ・ スターキー補聴器の調整のみに使用してください。